



1-1

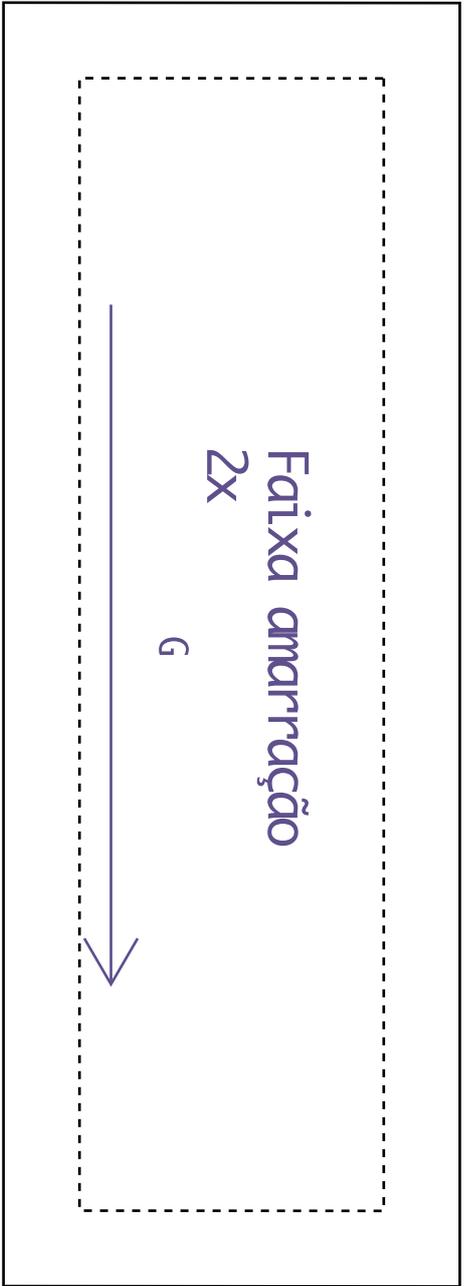

Dobra

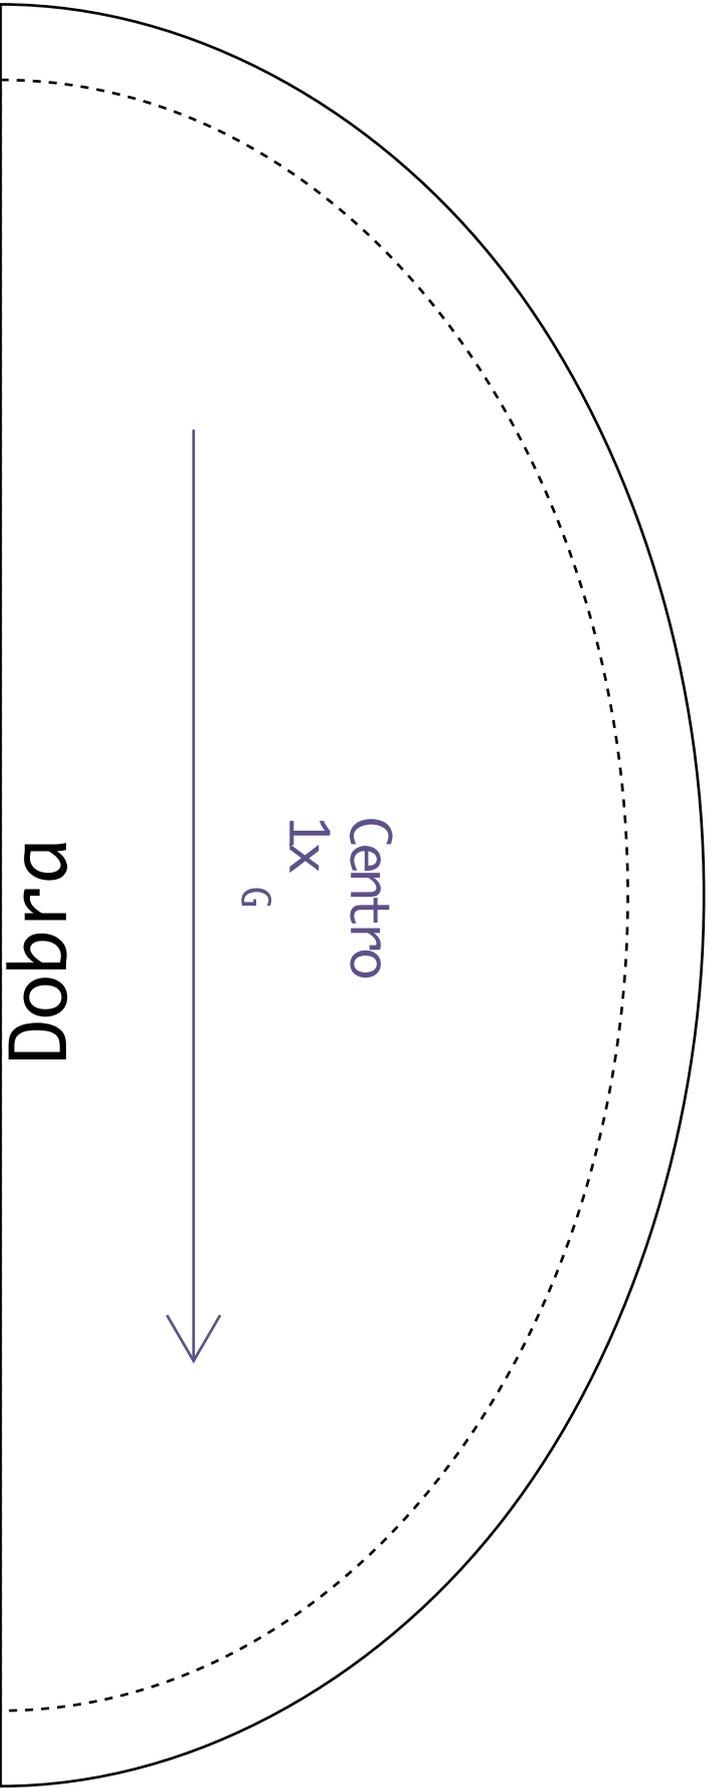

G

IX


LaretaL


Instituto Diana Demarchi
Vai Paulo
Touca cirúrgica Unissex

PROIBIDA REVENDA

Fi
-T
-T
-3
Me
e
P:

Teste de impressão: ao imprimir seu molde, meça o quadrado que deverá ter a mesma medida informada (4cm), assim você se certificará que ele foi impresso no tamanho correto.

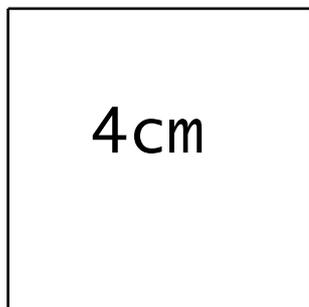

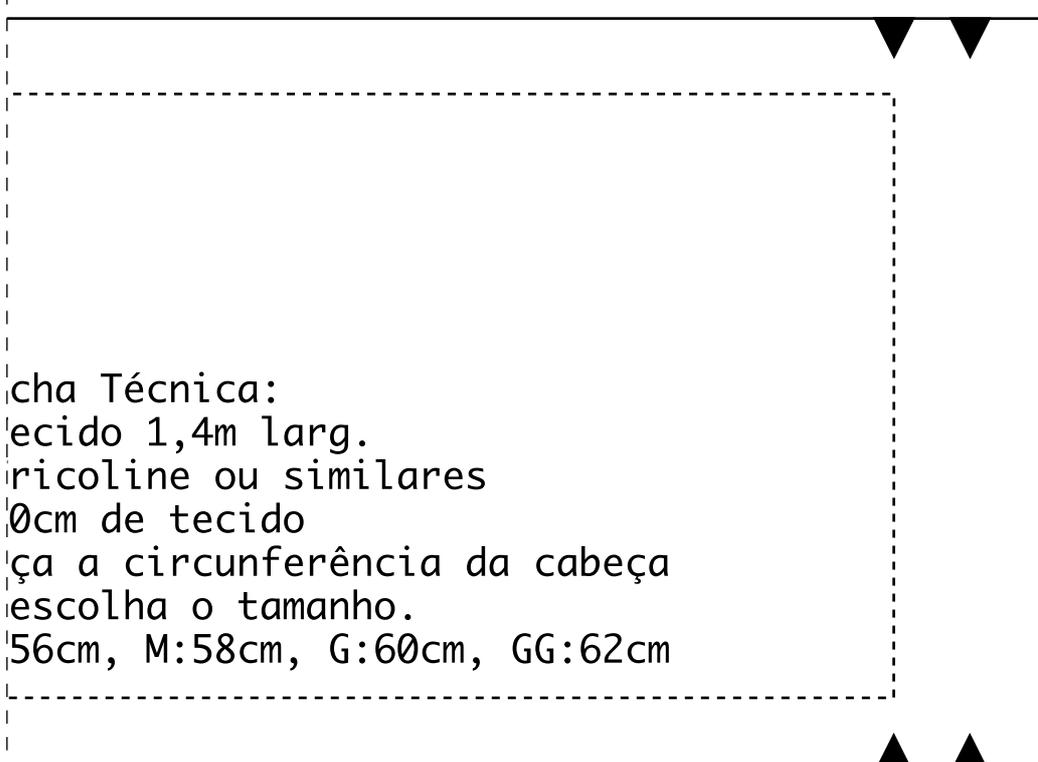

cha Técnica:
tecido 1,4m larg.
ricoline ou similares
10cm de tecido
escolha a circunferência da cabeça
escolha o tamanho.
P:56cm, M:58cm, G:60cm, GG:62cm